

المصادر

1. ملخص خصائص المنتج في المملكة العربية السعودية على موقع نظام معلومات الأدوية السعودي (SDI) : (<https://sdi.sfda.gov.sa>).

2. Diabetes UK, 2024. Side effects of insulin. [online] Available at: <https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/looking-after-diabetes/treatments/insulin/side-effects> [Accessed 20 September 2024].

ليفيمير® هو علامة تجارية مسجلة لشركة نوفو نورديسك ايه/اس
نوفو نورديسك هي علامة تجارية مسجلة لشركة نوفو نورديسك ايه/اس
نوفو نورديسك. جميع الحقوق محفوظة © 2024

إخلاء مسؤولية
أعد هذا الدليل التعليمي لأغراض التوعية وتقليل المخاطر فقط، ولا يجب اعتباره كمادة ترويجية أو تسويقية
للمنتج



يرجى الإبلاغ عن أي آثار جانبية من خلال القنوات التالية
(SFDA) الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
مركز الاتصال: 19999

البريد الإلكتروني
npc.drug@sfda.gov.sa
الموقع الإلكتروني
<http://ade.sfda.gov.sa>

شركة نوفو نورديسك السعودية
البريد الإلكتروني
nngulfsafety@novonordisk.com
الموقع الإلكتروني
<https://www.novonordisk.com.sa>




معلومات هامة لتقليل المخاطر للمرضى:

الإيقاف التدريجي لعقار ليفيمير® إنسولين ديتيمير

1. هذه المعلومات موجهة لمرضى السكري الذين وُصف لهم عقار ليفيمير®. يهدف هذا الانتقال إلى ضمان استمرار المرضى في الحصول على أفضل خيارات العلاج المتاحة.
2. يجب عليك التحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن لمناقشة الخيارات العلاجية البديلة المناسبة لك والاستعداد لبدء استخدام علاج إنسولين آخر.

توفر هذه النشرة معلومات حول الإيقاف التدريجي لعقار ليفيمير® الذي تقوم به شركة نوفو نورديسك وتأثير ذلك عليك.

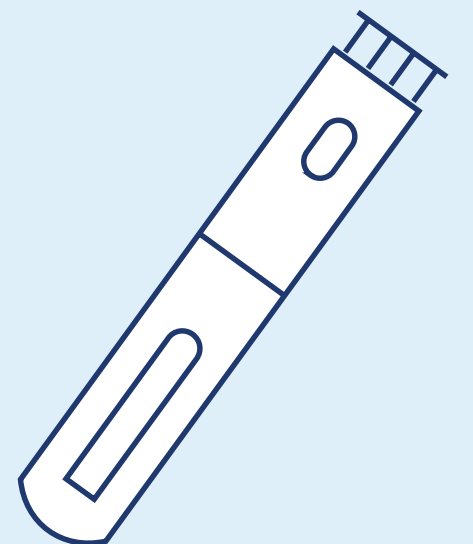


لماذا تقوم شركة نوفو نورديسك بإيقاف إصدار عقار ليفيمير® في الأسواق بشكل تدريجي؟

ترغب شركة نوفو نورديسك في تقديم الأدوية التي ستفيد أكبر عدد من المرضى على مستوى العالم وتخدمهم على أفضل وجه في نهاية المطاف. ونظرًا لتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من داء السكري وحاجتنا إلى تلبية متطلبات المرضى بشكل أفضل مع توفير إمدادات مستقرة من المنتجات، فإننا نقوم بإعادة هيكلة مجموعة منتجاتنا.

ونتيجة لذلك، يتم إيقاف إصدار عقار ليفيمير® بشكل تدريجي في جميع أنحاء العالم.

إن الأولوية القصوى لشركة نوفو نورديسك هي دائمًا صحة وسلامة المرضى. وقد تم اتخاذ قرار إيقاف التدريجي لإصدار منتجات الإنسولين الأساسية، مثل عقار ليفيمير® بعد دراسة متأنية، وليس نتيجة لأي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الجودة. تظل شركة نوفو نورديسك ملتزمة بتقديم الدعم والمعلومات لخبراء الرعاية الصحية طوال هذه العملية لضمان استمرار تقديم الرعاية.

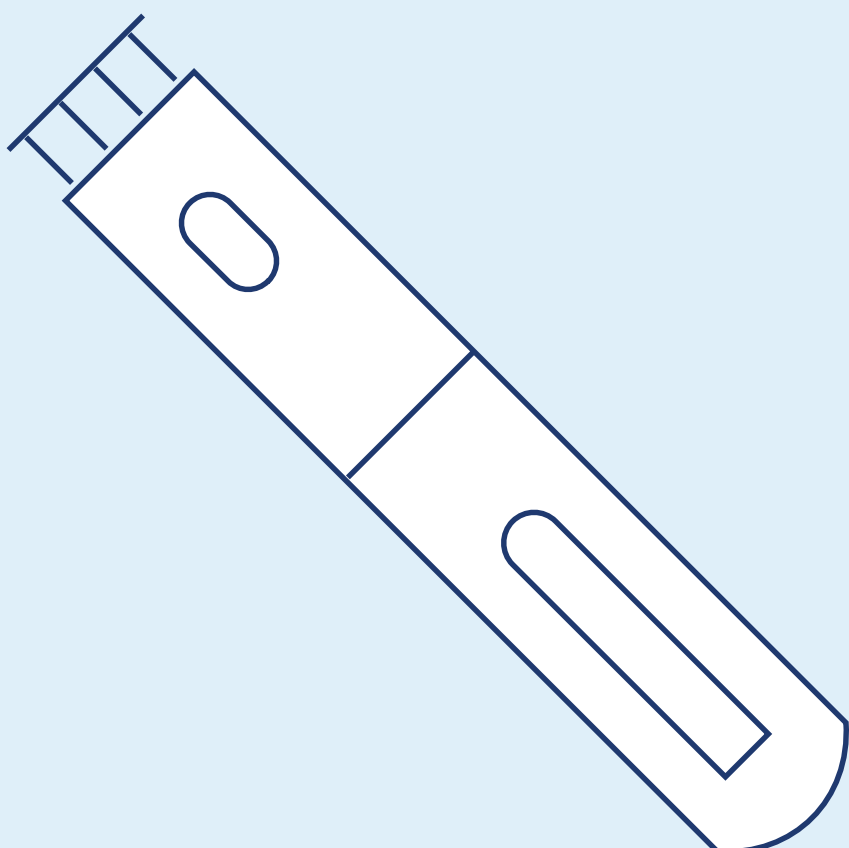

متى سيتم إيقاف إصدار الإنسولين الخاص بي في الأسواق بشكل تدريجي؟

• سيتم إيقاف إصدار عقار ليفيمير® في الأسواق تدريجيًا في المملكة العربية السعودية بحلول عام ٢٠٢٦.

• يجب عليك التحدث إلى طبيبك في أقرب فرصة ممكنة لإيجاد علاج بديل مناسب لك؛ لتجنب انقطاعك عن العلاج.

إن عملية الإيقاف التدريجي للإنسولين الخاص بي قد بدأت بالفعل، فما هي الخطوات التالية التي يتعين عليّ اتخاذها؟

• يجب أن يقوم طبيبك بمتابعتك عن كثب عند بدء استخدام العلاج الجديد لضمان سلامتك.

• سيساعدك طبيبك في إيجاد خيار علاجي مختلف بالاعتماد على تاريخك الطبي، ورأيه الطبي، واحتياجاتك الفردية، ومعرفة المنتجات المتوفرة في البلد الذي تعيش فيه..

ما يجب أخذه في الاعتبار عند تغيير الإنسولين:

• كما هو الحال مع جميع الأدوية الموصوفة، فإن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف.

• تحقق من نشرة المعلومات المرفقة مع الإنسولين الخاص بك لمعرفة الأعراض الجانبية المحتملة. تذكر أنك من غير المرجح أن تواجه جميع الأعراض الجانبية.

• يجب عليك إبلاغ طبيبك المختص إذا شعرت بالصداع أو الغثيان أو أعراض مشابهة للأنفلونزا خلال الـ ٧٢ ساعة الأولى من بدء أي نوع جديد من الإنسولين.