

المصادر

1. (SDI) ملخص خصائص المنتج في المملكة العربية السعودية على موقع نظام معلومات الأدوية السعودي (/https://sdi.sfda.gov.sa)

2. Diabetes UK, 2024. Side effects of insulin. [online] Available at: <https://www.diabetes.org.uk/about-diabetes/looking-after-diabetes/treatments/insulin/side-effects> [Accessed 20 September 2024].

إخلاء مسؤولية

أعد هذا الدليل التعليمي لأغراض التوعية وتقليل المخاطر فقط، ولا يجب اعتباره كمادة ترويجية أو تسويقية للمنتج



يُرجى الإبلاغ عن أي آثار جانبية من خلال القنوات التالية (SFDA).

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية

مركز الاتصال: 19999

البريد الإلكتروني

npc.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني

<http://ade.sfda.gov.sa>

شركة نوفو نورديسك السعودية

البريد الإلكتروني: nngulfsafety@novonordisk.com

الموقع الإلكتروني

<https://www.novonordisk.com.sa>




معلومات هامة لتقليل المخاطر للمرضى:

الإيقاف التدريجي لعبوات الإنسولين المخصصة لأقلام أكترابيد® ، وإنسولاتارد® ، وميكستارد® ٣٠ (بنفل®)

١. هذه المعلومات موجهة لمرضى السكري الذين وُصف لهم عبوات الإنسولين المخصصة لأقلام أكترابيد® ، وإنسولاتارد® ، وميكستارد® ٣٠ (بنفل®) . يهدف هذا الانتقال إلى ضمان استمرار المرضى في الحصول على أفضل خيارات العلاج المتاحة.
٢. يجب عليك التحدث مع طبيبك في أقرب وقت ممكن لمناقشة الخيارات العلاجية البديلة المناسبة لك والاستعداد لبدء استخدام إنسولين و/أو جهاز آخر.

توفر هذه النشرة معلومات حول الإيقاف التدريجي لمنتجات الإنسولين البشري (بنفل®) الخاصة بشركة نوفو نورديسك وتأثير ذلك عليك.

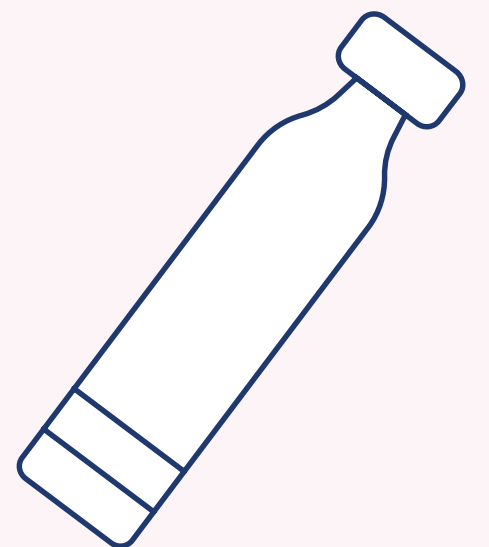


لماذا يتم إيقاف إصدار منتجات الإنسولين البشري في الأسواق بشكل تدريجي؟

ترغب شركة نوفو نورديسك في تقديم الأدوية التي ستفيد أكبر عدد من المرضى على مستوى العالم وتخدمهم على أفضل وجه في نهاية المطاف. ونظرًا لتزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من داء السكري وحاجتنا إلى تلبية متطلبات المرضى بشكل أفضل مع توفير إمدادات مستقرة من المنتجات، فإننا نقوم بإعادة هيكلة مجموعة منتجاتنا.

ونتيجة لذلك، سنقوم بإيقاف إصدار المنتجات التالية في الأسواق بشكل تدريجي:

- عبوات الإنسولين المخصصة لأقلام أكترابيد® (بنفل®)
- عبوات الإنسولين المخصصة لأقلام إنسولاتارد® (بنفل®)
- عبوات الإنسولين المخصصة لأقلام ميكستارد® ٣٠ (بنفل®)

ندرك أن هذا القرار سيكون صعبًا على مرضى السكري الذين يعتمدون على علاجاتنا. ومع ذلك، من خلال اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي، سنتمكن من زيادة عدد المرضى الذين نصل إليهم بالملايين خلال العقد المقبل. ونسعى جاهدين لعدم ترك المرضى دون خيارات علاجية بديلة، سواء من خلال منتجات نوفو نورديسك أو شركات أخرى. كما سنعمل عن كثب مع الجهات الصحية والمجتمع الطبي، وسنلتزم باللوائح المحلية المعمول بها لضمان وصول المرضى إلى الأدوية التي يحتاجون إليها.

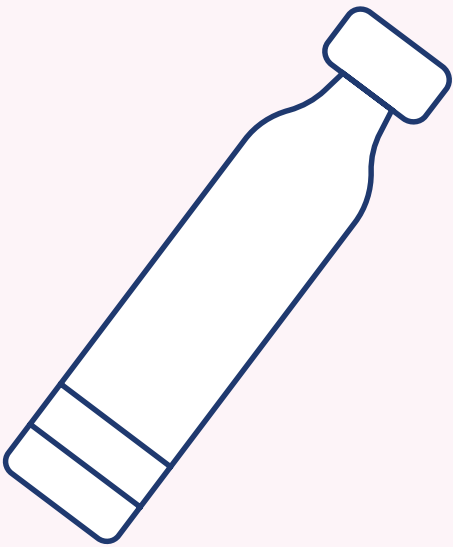

متى سيتم إيقاف إصدار الإنسولين الخاص بي في الأسواق بشكل تدريجي؟

- سيتم إيقاف إصدار عبوات الإنسولين المخصصة لأقلام أكترابيد®، وإنسولاتارد®، وميكستارد ٣® في الأسواق بالمملكة العربية السعودية بحلول عام ٢٠٢٦، بينما سيستمر إصدار أمبولات أكترابيد®، وإنسولاتارد®، وميكستارد ٣®.
- يجب عليك التحدث إلى طبيبك في أقرب فرصة ممكنة لإيجاد إنسولين و/أو جهاز بديل مناسب لك؛ لتجنب انقطاعك عن العلاج.

إن عملية الإيقاف التدريجي للإنسولين الخاص بي قد بدأت بالفعل، فما هي الخطوات التالية التي يتعين عليّ اتخاذها؟

- إذا كنت تستخدم أيًا من المنتجات المذكورة المدرجة في الصفحة المقابلة، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول بدء استخدام إنسولين و/أو جهاز بديل.
- سيساعدك طبيبك في بدء استخدام الأمبولات بدلاً من عبوات الإنسولين المخصصة للأقلام من نفس الإنسولين الذي تستخدمه أو بدء استخدام إنسولين مختلف، وذلك بالاعتماد على تاريخك الطبي، ورأيه الطبي، واحتياجاتك الفردية، ومعرفة المنتجات المتوفرة في البلد الذي تعيش فيه.
- كما سيقوم أيضًا بمتابعتك عن كثب عند بدء استخدام الإنسولين/الجهاز الجديد لضمان سلامتك.

ما يجب أخذه في الاعتبار عند تغيير الإنسولين:

- كما هو الحال مع جميع الأدوية الموصوفة، فإن كل شخص يتفاعل بشكل مختلف.
- تحقق من نشرة المعلومات المرفقة مع الإنسولين الخاص بك لمعرفة الأعراض الجانبية المحتملة. تذكر أنك من غير المرجح أن تواجه جميع الأعراض الجانبية.
- يجب عليك إبلاغ طبيبك المختص إذا شعرت بالصداع أو الغثيان أو أعراض مشابهة للأنفلونزا خلال الـ ٧٢ ساعة الأولى من بدء أي نوع جديد من الإنسولين.